

ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО
ПО ТЕХНИЧЕСКОМУ РЕГУЛИРОВАНИЮ И МЕТРОЛОГИИ

СЕРТИФИКАТ

об утверждении типа средств измерений
№ 74129-19

Срок действия утверждения типа до **20 февраля 2029 г.**

НАИМЕНОВАНИЕ И ОБОЗНАЧЕНИЕ ТИПА СРЕДСТВ ИЗМЕРЕНИЙ
Датчики тока Т201

ИЗГОТОВИТЕЛЬ
Фирма "SENECA srl", Италия

ПРАВООБЛАДАТЕЛЬ
-

КОД ИДЕНТИФИКАЦИИ ПРОИЗВОДСТВА
ОС

ДОКУМЕНТ НА ПОВЕРКУ
МП 206.1-034-2018

ИНТЕРВАЛ МЕЖДУ ПОВЕРКАМИ **4 года**

Срок действия утвержденного типа средств измерений продлен приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии **от 28 декабря 2023 г. N 2825.**

Заместитель Руководителя

Е.Р.Лазаренко

Подлинник электронного документа, подписанного ЭП,
хранится в системе электронного документооборота
Федеральное агентство по техническому регулированию и
метрологии.

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат: 646070CB8580659469A85BF6D1B138C0
Кому выдан: Лазаренко Евгений Русланович
Действителен: с 20.12.2022 до 14.03.2024

«05» февраля 2024 г.



ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО
ПО ТЕХНИЧЕСКОМУ РЕГУЛИРОВАНИЮ И МЕТРОЛОГИИ

СВИДЕТЕЛЬСТВО

об утверждении типа средств измерений

ОС.С.34.004.А № 72960

Срок действия до 20 февраля 2024 г.

НАИМЕНОВАНИЕ ТИПА СРЕДСТВ ИЗМЕРЕНИЙ
Датчики тока Т201

ИЗГОТОВИТЕЛЬ
SENECA srl, Италия

РЕГИСТРАЦИОННЫЙ № 74129-19

ДОКУМЕНТ НА ПОВЕРКУ
МП 206.1-034-2018

ИНТЕРВАЛ МЕЖДУ ПОВЕРКАМИ 4 года

Тип средств измерений утвержден приказом Федерального агентства по
техническому регулированию и метрологии от 20 февраля 2019 г. № 275

Описание типа средств измерений является обязательным приложением
к настоящему свидетельству.

Заместитель Руководителя
Федерального агентства

А.В.Кулешов



03

..... 2019 г.

Серия СИ

№ 034537

ОПИСАНИЕ ТИПА СРЕДСТВА ИЗМЕРЕНИЙ

Датчики тока Т201

Назначение средства измерений

Датчики тока Т201 (далее – датчики) предназначены для преобразования силы постоянного и переменного тока в силу или напряжение постоянного тока, пригодные для измерения стандартными приборами.

Описание средства измерений

Принцип действия основан на явлении взаимной индукции или эффекте Холла.


Датчики состоят из преобразователя тока, блока усилителей, переключателей диапазонов измерений и клемм для подсоединения вторичных приборов. Все компоненты датчиков размещены в корпусе из РА6 пластика.

Первичной обмоткой датчиков является внешний провод, наматываемый на него.

В модификациях на эффекте Холла преобразованные значения силы тока, усиливаются на выходе с помощью внешнего источника питания напряжения постоянного тока.

Датчики выпускаются в следующих модификациях:

Т201 XXX XXX - XX

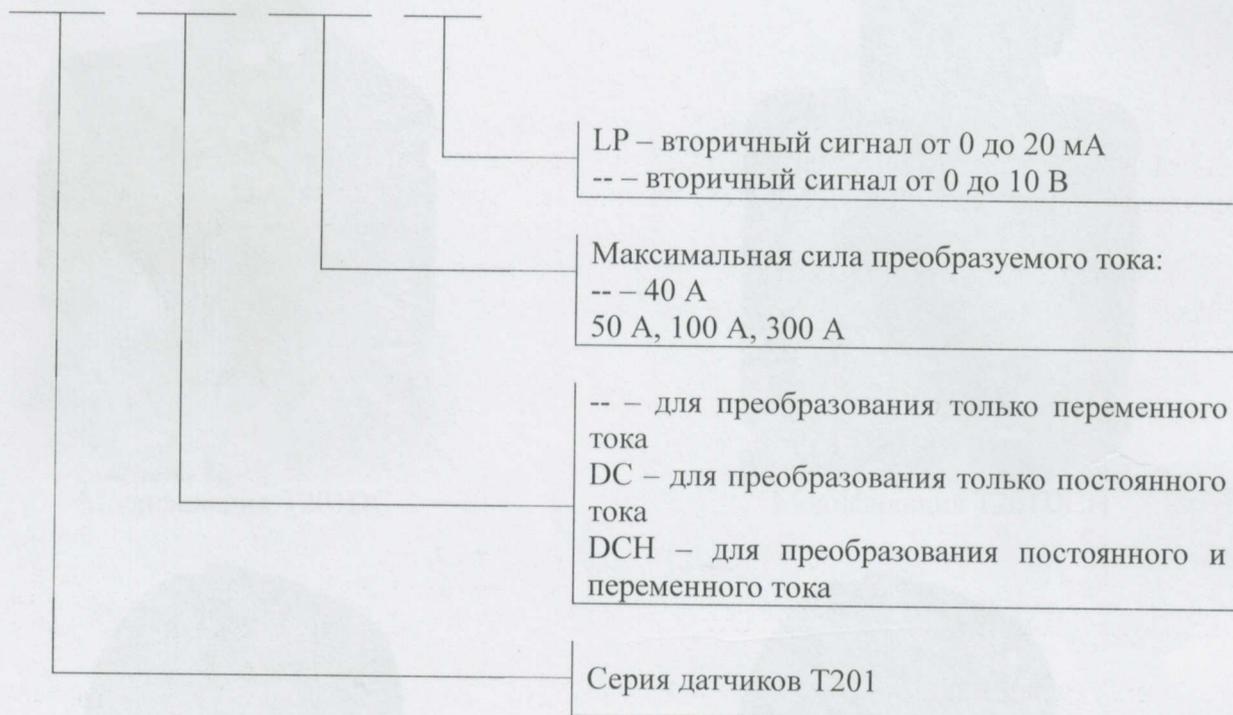

Общий вид датчиков приведен на рисунке 1.
Место пломбировки от несанкционированного доступа представлено на рисунке 2.



Модификация T201



Модификация T201DCH50-LP




Модификация T201DC




Модификация T201DCH



Модификации T201DCH100-LP, T201DCH300-LP

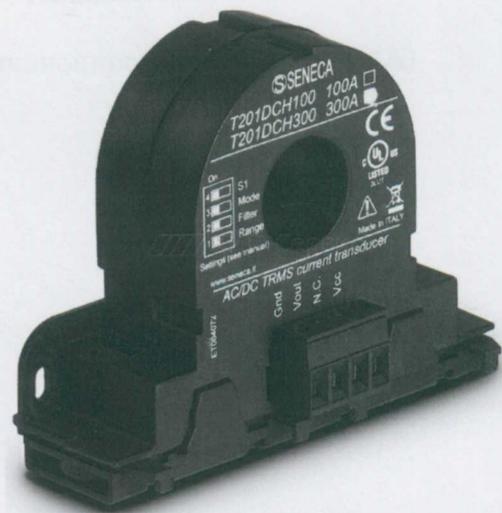

Модификации T201DCH100, T201DCH300

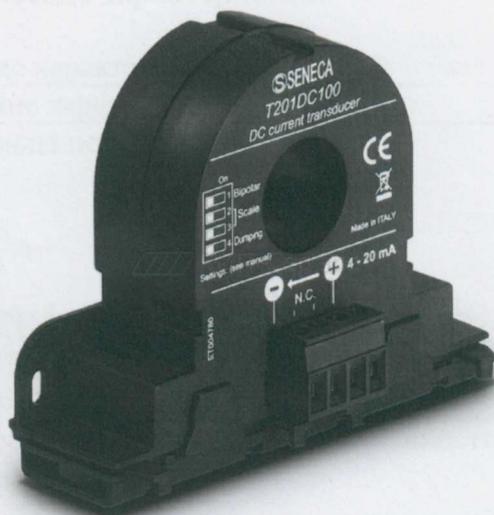

Модификация T201DC100

Рисунок 1 - Общий вид средства измерений

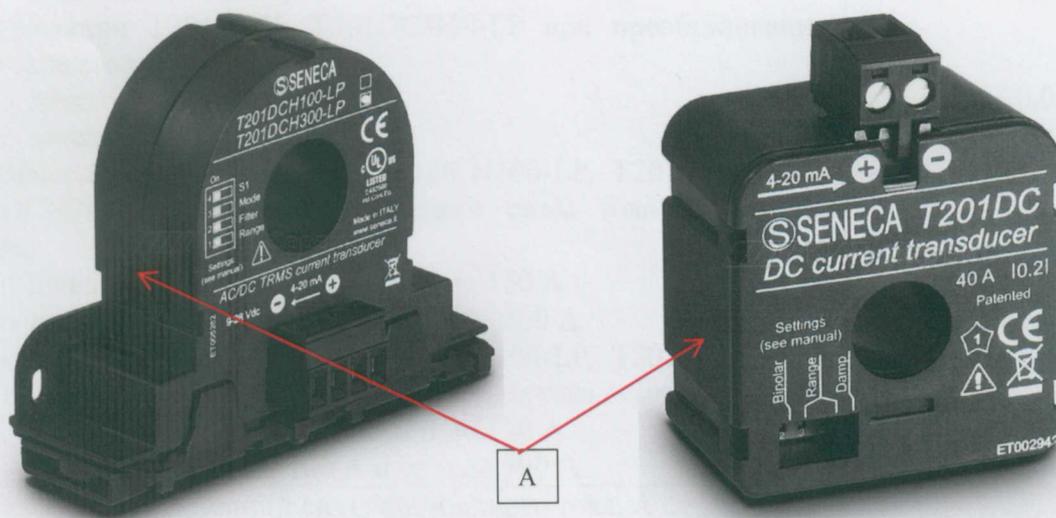


Рисунок 2 - Место пломбировки от несанкционированного доступа (А)

Программное обеспечение
отсутствует.

Метрологические и технические характеристики

Таблица 1 - Метрологические характеристики

Наименование характеристики	Значение
<p>Диапазоны преобразований силы переменного тока, А</p> <ul style="list-style-type: none"> - для T201 - для T201DCH, T201DCH50-LP - для T201DCH100, T201DCH100-LP - для T201DCH300, T201DCH300-LP 	<p>от 0 до 5; от 0 до 10; от 0 до 15; от 0 до 20; от 0 до 25; от 0 до 30; от 0 до 35; от 0 до 40 от 0 до 25; от 0 до 50 от 0 до 50; от 0 до 100 от 0 до 150; от 0 до 300</p>
<p>Пределы допускаемой абсолютной основной погрешности преобразований силы переменного тока, А</p> <p>Модификация T201:</p> <ul style="list-style-type: none"> - диапазон от 0 до 5 А - остальные диапазоны <p>Модификации T201DCH, T201DCH50-LP при преобразовании силы тока до $0,02 \cdot I_{\text{ш}}$ включ.:</p> <ul style="list-style-type: none"> - диапазон от 0 до 25 А - диапазон от 0 до 50 А <p>Модификации T201DCH, T201DCH50-LP при преобразовании силы тока свыше $0,02 \cdot I_{\text{ш}}$:</p> <ul style="list-style-type: none"> - диапазон от 0 до 25 А - диапазон от 0 до 50 А <p>Модификации T201DCH100, T201DCH100-LP, T201DCH300 и T201DCH300-LP при преобразовании силы тока до $0,02 \cdot I_{\text{ш}}$ включ.:</p> <ul style="list-style-type: none"> - диапазоны от 0 до 50 А и от 0 до 150 А - диапазоны от 0 до 100 А и от 0 до 300 А <p>Модификации T201DCH100, T201DCH100-LP, T201DCH300 и T201DCH300-LP при преобразовании силы тока свыше $0,02 \cdot I_{\text{ш}}$:</p> <ul style="list-style-type: none"> - диапазоны от 0 до 50 А и от 0 до 150 А - диапазоны от 0 до 100 А и от 0 до 300 А 	<p>$\pm(0,001 \cdot I_{\text{изм}} + 0,002 \cdot I_{\text{ш}})^*$ $\pm(0,002 \cdot I_{\text{изм}} + 0,002 \cdot I_{\text{ш}})^*$</p> <p>$\pm 0,02 \cdot I_{\text{ш}}^*$ $\pm 0,01 \cdot I_{\text{ш}}^*$</p> <p>$\pm 0,01 \cdot I_{\text{ш}}^*$ $\pm 0,005 \cdot I_{\text{ш}}^*$</p> <p>$\pm 0,02 \cdot I_{\text{ш}}^*$ $\pm 0,01 \cdot I_{\text{ш}}^*$</p> <p>$\pm 0,01 \cdot I_{\text{ш}}^*$ $\pm 0,005 \cdot I_{\text{ш}}^*$</p>
<p>Диапазон преобразований силы постоянного тока, А</p> <ul style="list-style-type: none"> - для T201DC - для T201DC100 - для T201DCH100 и T201DCH100-LP - для T201DCH300 и T201DCH300-LP - для T201DCH50-LP - для T201DCH 	<p>от 0 до 5; от 0 до 10; от 0 до 20; от 0 до 40; от -5 до 5; от -10 до 10; от -5 до 20; от -10 до 40 от 0 до 10; от 0 до 25; от 0 до 50; от 0 до 100; от -10 до 10; от -25 до 25; от -10 до 50; от -25 до 100 от 0 до 50; от 0 до 100 от -50 до 50; от -100 до 100 от 0 до 150; от 0 до 300 от -150 до 150; от -300 до 300</p> <p>от 0 до 25; от 0 до 50 от -25 до 25; от -50 до 50 от 0 до 25; от 0 до 50</p>

Продолжение таблицы 1

Наименование характеристики	Значение
Пределы допускаемой абсолютной основной погрешности преобразований силы постоянного тока, А	
Модификации T201DC, T201DC100	$\pm 0,002 \cdot I_{\text{изм}}^*$
Модификация T201DCH50-LP при преобразовании силы тока до $0,02 \cdot I_{\text{ш}}$ включ.:	
- диапазоны от 0 до 25 А и от -25 до 25	$\pm 0,04 \cdot I_{\text{ш}}^*$
- диапазоны от 0 до 50 А и от -50 до 50	$\pm 0,02 \cdot I_{\text{ш}}^*$
Модификация T201DCH50-LP при преобразовании силы тока свыше $0,02 \cdot I_{\text{ш}}$:	
- диапазоны от 0 до 25 А и от -25 до 25	$\pm 0,02 \cdot I_{\text{ш}}^*$
- диапазоны от 0 до 50 А и от -50 до 50	$\pm 0,01 \cdot I_{\text{ш}}^*$
Модификация T201DCH при преобразовании силы тока до $0,02 \cdot I_{\text{ш}}$ включ.:	
- диапазон от 0 до 25 А	$\pm 0,02 \cdot I_{\text{ш}}^*$
- диапазон от 0 до 50 А	$\pm 0,01 \cdot I_{\text{ш}}^*$
Модификация T201DCH при преобразовании силы тока свыше $0,02 \cdot I_{\text{ш}}$:	
- диапазон от 0 до 25 А	$\pm 0,01 \cdot I_{\text{ш}}^*$
- диапазон от 0 до 50 А	$\pm 0,005 \cdot I_{\text{ш}}^*$
Модификации T201DCH100, T201DCH100-LP, T201DCH300 и T201DCH300-LP при преобразовании силы тока до $0,02 \cdot I_{\text{ш}}$ включ.:	
- диапазоны от 0 до 50 А, от 0 до 150 А, от -50 до 50 А, от -150 до 150 А	$\pm 0,04 \cdot I_{\text{ш}}^*$
- диапазоны от 0 до 100 А, от 0 до 300 А, от -100 до 100 А, от -300 до 300 А	$\pm 0,02 \cdot I_{\text{ш}}^*$
Модификации T201DCH100, T201DCH100-LP, T201DCH300, T201DCH300-LP при преобразовании силы тока свыше $0,02 \cdot I_{\text{ш}}$:	
- диапазоны от 0 до 50 А, от 0 до 150 А, от -50 до 50 А, от -150 до 150 А	$\pm 0,02 \cdot I_{\text{ш}}^*$
- диапазоны от 0 до 100 А, от 0 до 300 А, от -100 до 100 А, от -300 до 300 А	$\pm 0,01 \cdot I_{\text{ш}}^*$
Диапазон значений силы постоянного тока во вторичной цепи для модификаций T201, T201DC, T201DC100, T201DCH50-LP, T201DCH100-LP, T201DCH300-LP, мА	от 4 до 20
Диапазон значений напряжения постоянного тока во вторичной цепи для модификаций T201DCH, T201DCH100, T201DCH300, В	от 0 до 10
Пределы допускаемой дополнительной погрешности от изменения температуры окружающей среды в диапазоне рабочих температур на каждые 10 °С относительно 23 °С, в долях от пределов допускаемой основной погрешности	0,002
Нормальные условия измерений:	
- температура окружающей среды, °С	от +15 до +25
- относительная влажность, %	от 30 до 80
- атмосферное давление, кПа	от 84 до 106
Примечание:	
* где: - $I_{\text{ш}}$ – значение полной шкалы диапазона, на котором производятся измерения, А	
- $I_{\text{изм}}$ – измеренное значение силы тока, А	

Таблица 2 - Основные технические характеристики

Наименование характеристики	Значение
Параметры электрического питания от внешнего источника напряжения постоянного тока, В: - для Т201 - для Т201DC, Т201DC100 - для Т201DCH50-LP, Т201DCH100-LP, Т201DCH300-LP - для Т201DCH, Т201DCH100, Т201DCH300	от 5 до 28 от 6 до 28 от 9 до 28 от 11,5 до 28
Потребляемый ток электрического питания от внешнего источника напряжения постоянного тока, мА, не более	25
Габаритные размеры средства измерений (высота×ширина×длина), мм, не более - для Т201, Т201DCH, Т201DCH50-LP, Т201DC - для Т201DC100, Т201DCH100, Т201DCH300, Т201DCH100-LP, Т201DCH300-LP,	44×26×41 68×26×95
Масса, кг, не более: - для Т201, Т201DC, Т201DCH50-LP - для Т201DCH - для Т201DC100, Т201DCH100, Т201DCH300, Т201DCH100-LP, Т201DCH300-LP, Т201DCH50-M, Т201DCH100-M, Т201DCH300-M	0,047 0,051 0,120
Условия эксплуатации: - температура окружающей среды, °С для Т201 для Т201DC, Т201DC100, Т201DCH для Т201DCH100, Т201DCH300, Т201DCH50-LP, Т201DCH100-LP, Т201DCH300-LP, Т201DCH50-M, Т201DCH100-M, Т201DCH300-M - относительная влажность при +20 °С, % - атмосферное давление, кПа	от -20 до +65 от -10 до +65 от -20 до +70 до 90 от 80 до 106
Средний срок службы, лет	8
Средняя наработка на отказ, ч	7000

Знак утверждения типа

наносится типографским способом на титульный лист руководства по эксплуатации.

Комплектность средства измерений

Таблица 3 - Комплектность средства измерений

Наименование	Обозначение	Количество
Датчики тока	Т201	1 шт.
Паспорт	-	1 экз.
Руководство по эксплуатации	-	1 экз.
Методика поверки	МП 206.1-034-2018	1 экз.

Поверка

осуществляется по документу МП 206.1-034-2018 «Датчики тока Т201. Методика поверки», утвержденному ФГУП «ВНИИМС» 20.11.2018 г.

Основные средства поверки:

- калибратор универсальный Fluke 9100 (Регистрационный № 25985-09);
- источник питания постоянного тока программируемый серии Genesys™ (мощностью от 0,75 до 5 кВт) (Регистрационный № 46742-11);
- шунт токовый АКИП-7501 (Регистрационный № 49121-12);
- мультиметр цифровой Fluke 8845А (Регистрационный № 57943-14);
- трансформатор тока эталонный двухступенчатый ИТТ-3000.5 (Регистрационный № 19457-00).

Допускается применение аналогичных средств поверки, обеспечивающих определение метрологических характеристик, поверяемых СИ с требуемой точностью.

Знак поверки наносится на лицевую панель датчиков или на свидетельство о поверке.

Сведения о методиках (методах) измерений
приведены в эксплуатационном документе.

Нормативные документы, устанавливающие требования к датчикам тока Т201
ГОСТ 22261-94 Средства измерений электрических и магнитных величин. Общие технические условия

Изготовитель

SENECA srl, Италия
Адрес: Via Austria, 26, 35127 Padova, Italy
Телефон: +39 049 8705359
E-mail: info@seneca.it
Web-сайт: www.seneca.it

Заявитель

Общество с ограниченной ответственностью «КИП-Сервис» (ООО «КИП-Сервис»)
ИНН 2308073661
Адрес: 350000, г. Краснодар, ул. Митрофана Седина, д. 145/1
Телефон: +7 (861) 255-97-54
E-mail: krasnodar@kipservis.ru
Web-сайт: www.kipservis.ru

Испытательный центр

Федеральное государственное унитарное предприятие «Всероссийский научно-исследовательский институт метрологической службы» (ФГУП «ВНИИМС»)
Адрес: 119361, г. Москва, ул. Озерная, д. 46
Телефон: +7 (495) 437-55-77
Web-сайт: www.vniims.ru
E-mail: office@vniims.ru
Аттестат аккредитации ФГУП «ВНИИМС» по проведению испытаний средств измерений в целях утверждения типа № 30004-13 от 29.03.2018 г.

Заместитель
Руководителя Федерального
агентства по техническому
регулированию и метрологии



А.В. Кулешов

М.п.

« 01 » 03

2019 г.